170824-2049-9-esonde-ult400.10.fid
Sample PS_OS_1
group carrei
PRO CDCl3 /opt/v esonde 9
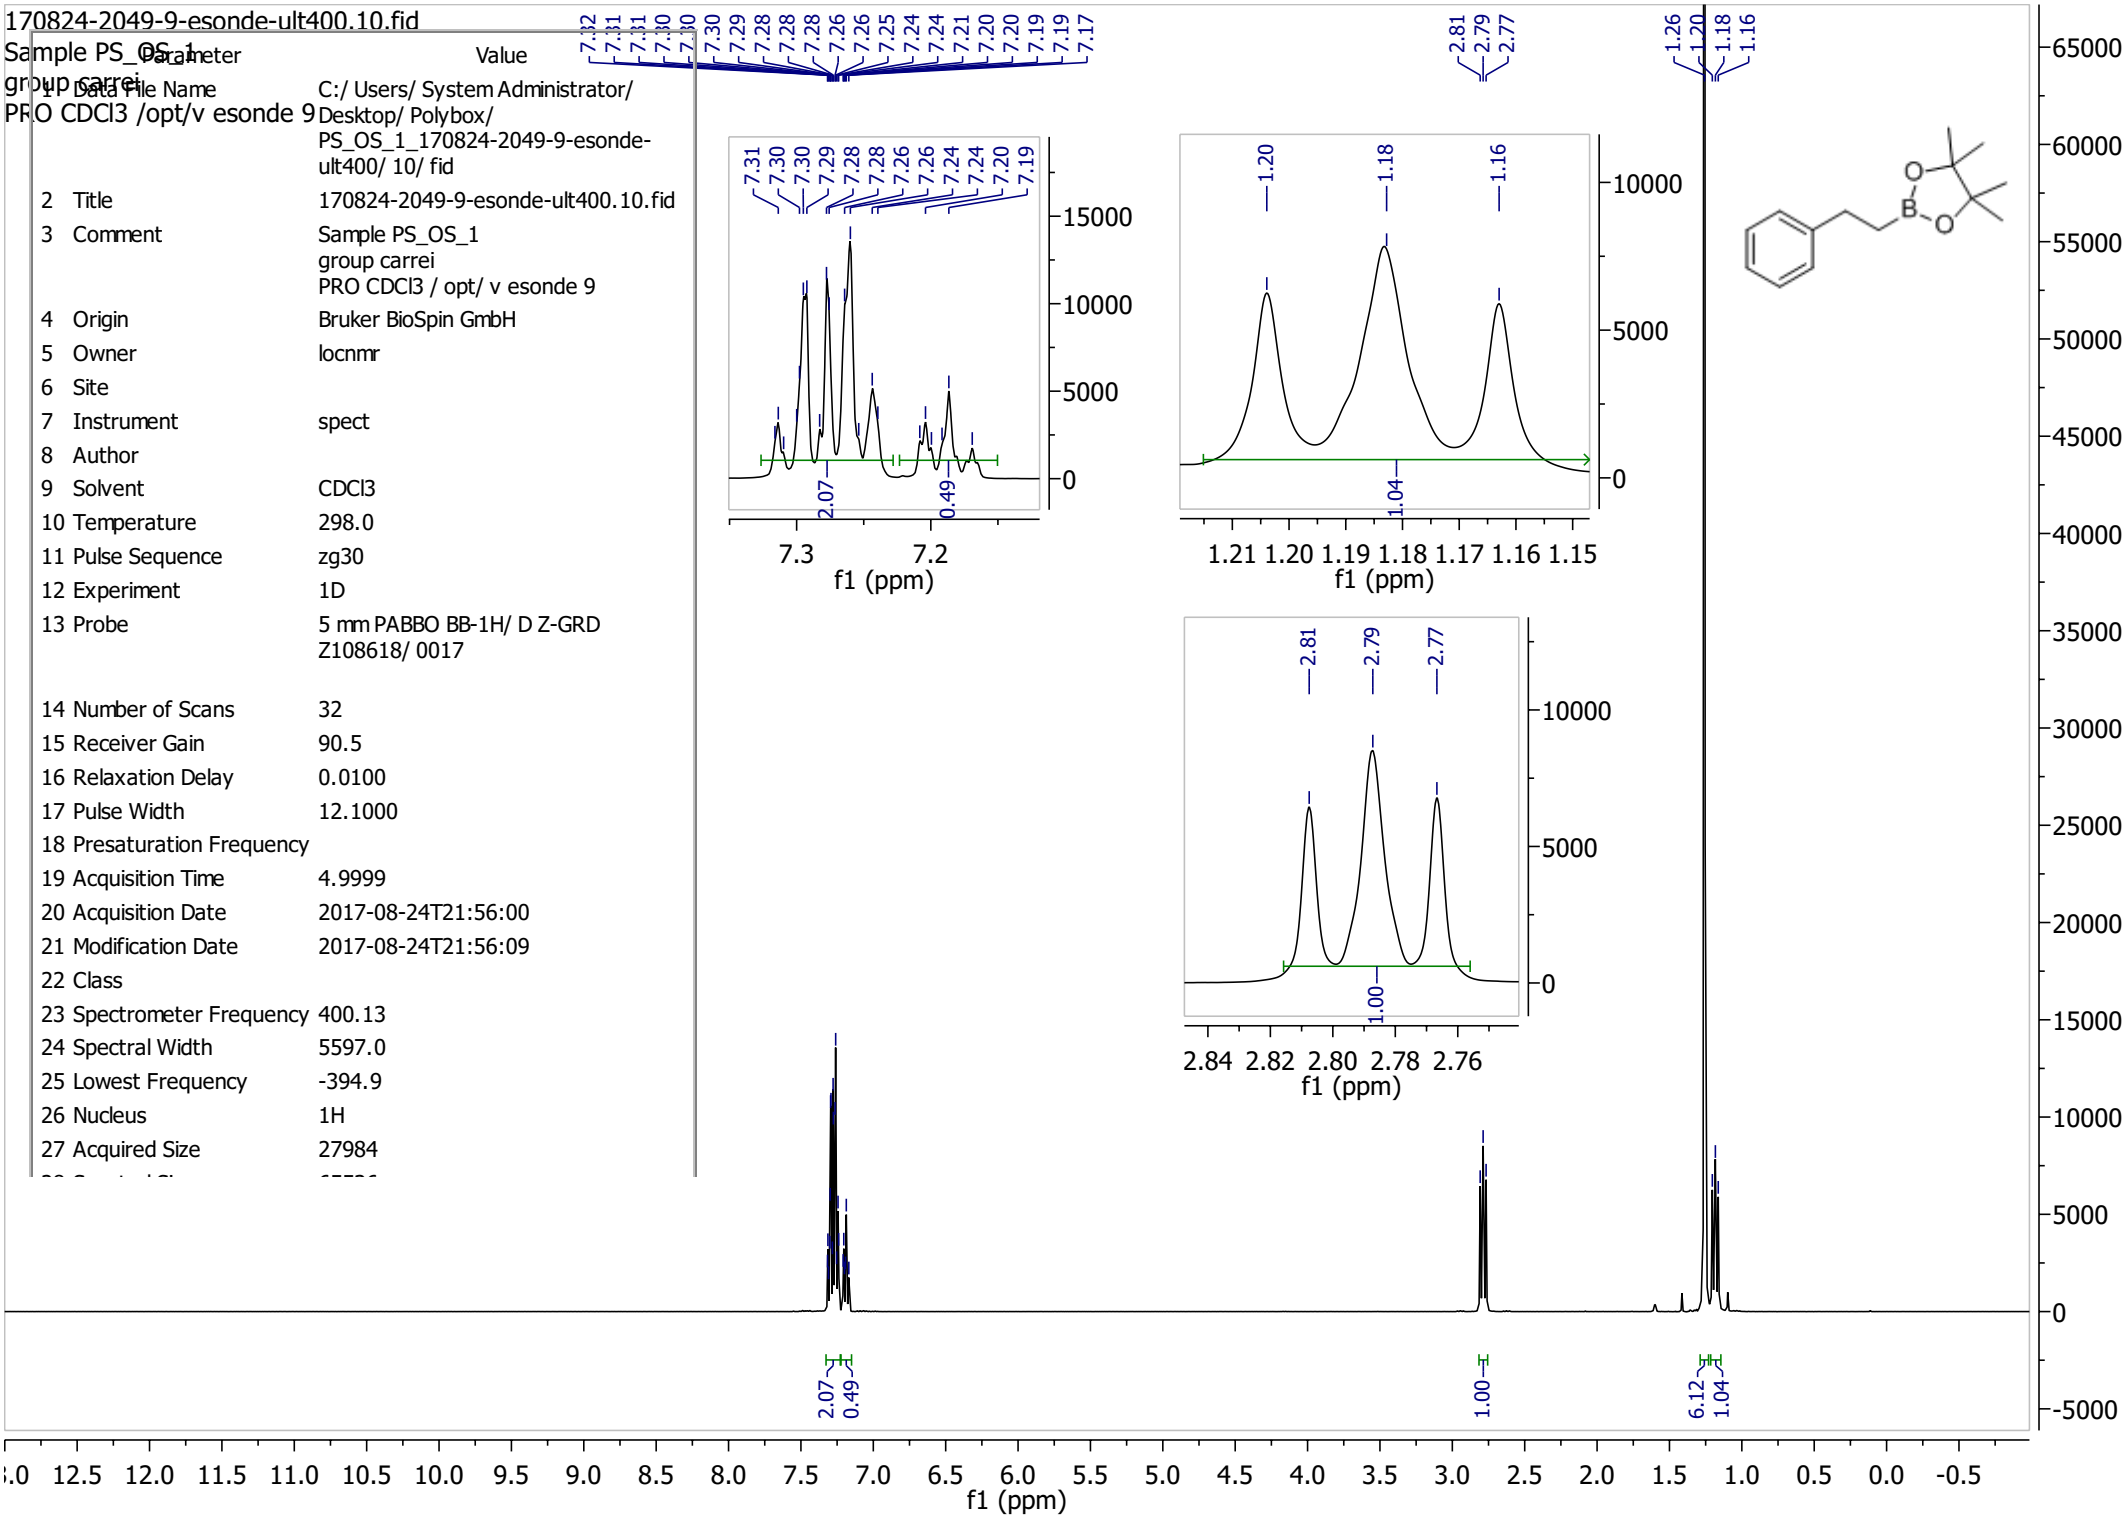
	Parameter	Value
1	Data File Name	C:/ Users/ System Administrator/ Desktop/ Polybox/ PS_OS_1_170824-2049-9-esonde-ult400/ 10/ fid
2	Title	170824-2049-9-esonde-ult400.10.fid
3	Comment	Sample PS_OS_1 group carrei PRO CDCl3 / opt/ v esonde 9
4	Origin	Bruker BioSpin GmbH
5	Owner	locnmr
6	Site	
7	Instrument	spect
8	Author	
9	Solvent	CDCl3
10	Temperature	298.0
11	Pulse Sequence	zg30
12	Experiment	1D
13	Probe	5 mm PABBO BB-1H/ D Z-GRD Z108618/ 0017
14	Number of Scans	32
15	Receiver Gain	90.5
16	Relaxation Delay	0.0100
17	Pulse Width	12.1000
18	Presaturation Frequency	
19	Acquisition Time	4.9999
20	Acquisition Date	2017-08-24T21:56:00
21	Modification Date	2017-08-24T21:56:09
22	Class	
23	Spectrometer Frequency	400.13
24	Spectral Width	5597.0
25	Lowest Frequency	-394.9
26	Nucleus	1H
27	Acquired Size	27984